

PROJECT E
BEAUTY



**LED RF Ultrasonic
Slimming Device
User Manual**

PE142

www.projecteauty.com

Introduction

Thank you for purchasing the Project E Beauty LED RF Ultrasonic Slimming Device. This device utilizes 3 different functions to treat a variety of skin and body conditions.

What separates this device from other beauty devices is the extra large ultrasound probe. Combine with Radio Frequency and Red LEDs, this takes skin care and body shaping to the next level and you will achieve results more effectively and faster than imaginable.

Features:

- 4-point focused RF
- 330K Hz Ultrasonic Technology
- USB Rechargeable
- Easy to Operate
- Noise Free

Ultrasonic Slimming

Ultrasonic(Ultrasound) slimming technology is a process where you transmit waves of ultrasonic into cellulite affected areas of your body. The frequency of the ultrasonic is set to disrupt the fat cells that are causing the cellulite to appear. The continuation of the cavitation therapy causes the fat to get mopped up within the lymphatic system and disposed of via the liver. The technology is very effective and a real technological breakthrough for getting rid of cellulite



Introduction

RF (Radio Frequency)

For detoxicating and promoting blood circulation. With RF, the electrical energy will follow the shortest distance between two electrodes. When the electric current runs through living tissue, the high energy flow produces heat, as the living tissue will resist electricity. Tissue in both the dermal and subcutaneous layers of the skin can be heated by RF energy. As well as increasing production of collagen and elastin, RF can also be used to contract collagen fibers, resulting in skin tightening. It is also used to improve lymphatic drainage, accelerate fat metabolism and for cellulite reduction.

RED LED

Red LED penetrates the skin approximately 8-10mm, which will stimulate fiber cells and the production of collagen, reducing wrinkles and making skin more elastic and smooth.

Safety Information

Use of the device when the following conditions exist may cause potential damage to the skin. Do not perform a treatment on affected areas of the person's body.

Relative Contraindications

- Cuts or abrasions
- Vascular conditions
- Hypersensitive skin
- Excessive body hair
- Sinus blockages
- Skin disorders or diseases
- Infections
- Sunburn
- Headaches or migraines



Safety Information

You must read, and understand, all of the safety warnings, operating and maintenance instructions before using the Project E Beauty LED RF Ultrasonic Slimming Device.

WARNING!: A hazard that may cause serious injury.

NOTICE: A hazard that may cause damage to the product.

WARNING!

- Performing a treatment on a person with absolute contraindications may cause serious injury or death. Do not perform a treatment on a person where absolute contraindications exist.
- Never use the device around water. Always dry your hands before performing a treatment.
- Use of the device around jewelry and metal may cause unexpected electrical shock. Always remove all jewelry and metal prior to a treatment.

Do not perform a treatment if the person has any of these conditions.

Absolute Contraindications

- | | |
|--|---------------------------|
| • Acute infectious disease or fever | • Epilepsy |
| • Nausea | • Pregnant |
| • Dysfunction or disorders of the nervous system | • Phlebitis or thrombosis |
| | • Heart disease |

NOTE: If you are under a doctor's care for any skin condition or if you think you may have a skin condition, please consult your physician before use.



What is Included




Project E Beauty LED RF
Ultrasonic Slimming
Device



USB Cable

Owner's Manual (Not Shown)

Location of Controls

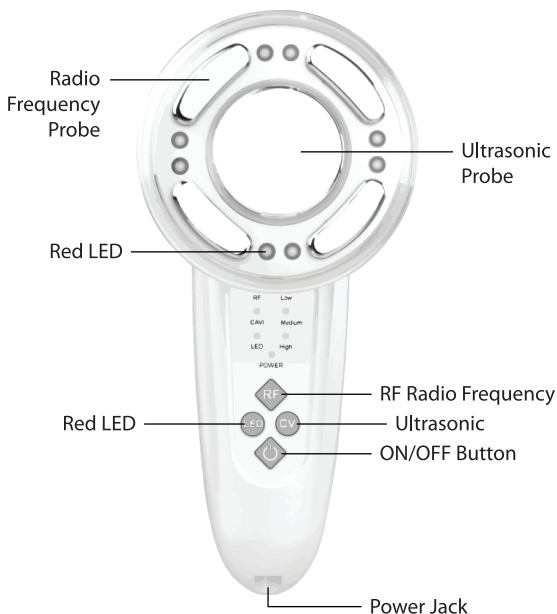

Benefits LED RF Ultrasonic Slimming Device

Radio Frequency Three different modes allow the users to perform treatments on different skin types and areas, and keep them from being damaged.

Extra large Treatment Probe can be used to perform treatments on numerous areas, such as arms, tight or body.

Benefits LED RF Ultrasonic Slimming Device

How Often

Ten to fifteen minutes for each treatment.

One to two treatments a week is recommended.

Use of the Device

Before performing a treatment you should do the following:

- Check if absolute or relative contraindications exist.
- Check that the device is functioning properly and the electrical cord is not damaged.
- Ensure there not any flammable materials near the workspace.

Follow these steps when performing a treatment:

- 1 Before your first use of the device, charge it at least 2 hours. (Note:
Flashing Power LED: Charging
Steady Power LED: Fully Charged

For charging:

Simply connect the USB cable to
common 5V USB power source

Connect the cable to the charging
jack on the massager.



NOTICE

The massager **CANNOT** be used during charging



Use of the Device

- 2 Disinfect the device using a soft cloth and carefully cleaning the electrodes and LED cover



- 3 Press and hold the On/Off button for 2 seconds to turn the unit on.



- 4 Press the LED button to turn on Red LED function (continuous mode).

Press again to switch to the Pulse mode. It provides short specific pulse of light energy, which enhances the treatments.



Use of the Device

- 5** Press the CV button to turn on ultrasonic slimming function.




- 6** Press the RF button to turn on Radio Frequency function.
Repeatedly press the RF button to select the desired RF power.

Note: The device is effective at all intensity levels including the lowest setting. It is not necessary to use the highest power level to achieve maximum results.



- 7** If desired, use Slimming Essence, Cream or your own products on area you will be working on to achieve the best results.




Use of the Device


BODY:

Approximate treatment time is 5-10 minutes for each area (Thighs/Legs, Buttocks, Back, Arms and Abs). If desired, use a Slimming Essence on areas you will be working on to achieve the best results.

ABS/STOMACH: It is recommended that the complete Ab/Stomach treatment should take 10 minutes. Slowly move in little circles, across the lower abdomen. Lift up and repeat for the upper abdomen.




Slowly move upwards from the top of the buttocks towards the lower back. Lift up and repeat on another area with the same movement.



ARMS: It is recommended that the complete arm treatment should take 5 minutes.

Slowly move in little circles, upwards from the back of the elbow to the inside shoulder. Lift up and do the outer shoulder.


Repeat for the front of the arms.



Use of the Device


BUTTOCKS: It is recommended that the complete buttocks treatment should take 5 minutes.

Slowly move in little circles, upwards from the upper rear thigh to the top of the buttocks. Lift up and repeat on another area of the buttocks.



Slowly move up and down in a small zig-zag motion on the buttocks.

Repeat for other cheek.



LEGS: It is recommended that the complete leg treatment should take 10 minutes.

Slowly move in little circles, upwards from above the back of the knee to the top of the outer thigh. Lift up and do the inner thigh.



Maintenance

- After each use, clean the surface using a soft cloth. Immediately dry off any moisture, chemicals or water on the device
- Store the device in a dry place.
- Keep out of reach of children



Warranty

The product comes with a full one year warranty against manufacturer defects. It does not include damage caused by misuse, accident, abuse, neglect or other external causes. The warranty is void if an unstable voltage or inappropriate power supply has been used.

Specifications

Model No.....	PE142
Input.....	DC 5V 1A
Output Power	Max 11W
Ultrasound Frequency.....	330KHz
Radio Frequency.....	500KHz
Battery Capacity.....	1400mAh
Auto Shut Off Timer.....	10min



E-mail: sales@projectebeauty.com

Website: www.projectebeauty.com



Introduction

Merci d'avoir acheté l'appareil d'amincissement ultrasonique LED RF de Project E Beauty. Cet appareil utilise 3 fonctions différentes pour traiter une variété de conditions de la peau et du corps.

Ce qui différencie cet appareil des autres appareils de beauté, c'est sa très grande sonde à ultrasons. Associée à la radiofréquence et aux LED rouges, elle porte les soins de la peau et le remodelage du corps à un niveau supérieur et vous obtiendrez des résultats plus efficaces et plus rapides que vous ne pouvez espérer.

Fonctionnalités:

- RF à 4 points de focalisation
- Technologie ultrasonique 330K Hz
- USB Rechargeable
- Facile à manier
- Pas de bruit

L'amincissement par ultrasons

La technologie d'amincissement par ultrasons (ultrasons) est un procédé qui consiste à transmettre des ondes ultrasonores dans les zones de votre corps touchées par la cellulite. La fréquence des ultrasons est définie de manière à perturber les cellules graisseuses à l'origine de l'apparition de la cellulite. La poursuite de la thérapie par cavitation permet à la graisse d'être éliminée par le système lymphatique et le foie. Cette technologie est très performante et constitue une véritable percée technologique pour se débarrasser de la cellulite.



Introduction

RF (Fréquence radio)

Pour désintoxiquer et promouvoir la circulation sanguine. Avec la RF, l'énergie électrique suivra la plus courte distance entre deux électrodes. Quand le courant électrique traverse un tissu vivant, le flux d'énergie élevé produit de la chaleur, car le tissu vivant résiste à l'électricité. Les tissus se trouvant dans les couches dermiques et sous-cutanées de la peau peuvent être chauffés par l'énergie RF. Outre l'augmentation de la production de collagène et d'élastine, les RF peuvent également être employées pour resserrer les fibres de collagène, ce qui entraîne un resserrement de la peau. Elle est également utilisée pour favoriser le drainage lymphatique, accélérer le métabolisme des graisses et pour la réduction de la cellulite.

LED ROUGE

La LED rouge pénètre la peau sur environ 8 à 10 mm, ce qui stimule les fibres cellulaires et la production de collagène, atténuant ainsi les rides et rendant la peau plus élastique et plus lisse.

Informations de sécurité

L'utilisation de l'appareil dans les conditions suivantes peut provoquer des dommages potentiels à la peau. N'effectuez pas de traitement sur les zones affectées du corps de la personne.

Contre-indications relatives

- Coupures ou abrasions
- Affections vasculaires
- Peau hypersensible
- Poils corporels excessifs
- Blocage des sinus
- Maladies de l'épiderme
- Infections
- Coups de soleil
- Maux de tête ou migraines



Informations de sécurité

Vous devez lire et comprendre tous les avertissements de sécurité et les consignes d'utilisation et d'entretien avant de vous servir de l'appareil d'amincissement par ultrasons LED RF de Project E Beauty.

AVERTISSEMENT!: Un danger qui peut occasionner des lésions graves.

REMARQUE: Un danger qui peut occasionner des dommages au produit.

ATTENTION

- Effectuer un traitement sur une personne disposant de contre-indications absolues peut entraîner des lésions graves ou la mort. N'effectuez pas de traitement sur une personne présentant des contre-indications absolues.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité de l'eau. Séchez toujours vos mains avant d'effectuer un traitement.
- L'utilisation de l'appareil à proximité de bijoux et de métal peut occasionner un choc électrique inattendu. Retirez toujours tous les bijoux et le métal avant le traitement.

Ne pas effectuer un traitement si la personne présente l'une des conditions suivantes.

Contre-indications absolues

- | | |
|--|-------------------------|
| • Maladie infectieuse aiguë ou fièvre. | • Epilepsie |
| • Nausée | • Enceinte |
| • Dysfonctionnement ou troubles du système nerveux | • Phlébite ou thrombose |
| | • Maladies cardiaques |

REMARQUE: Si vous êtes suivi par un médecin pour une quelconque affection de la peau ou si vous envisagez une affection de la peau, veuillez consulter votre médecin avant de l'utiliser.

Ce qui est compris




Dispositif Project E
Beauty LED RF
Ultrasonique
d'amincissement



Câble USB

Guide du propriétaire (Non afficher)

Emplacement des contrôles

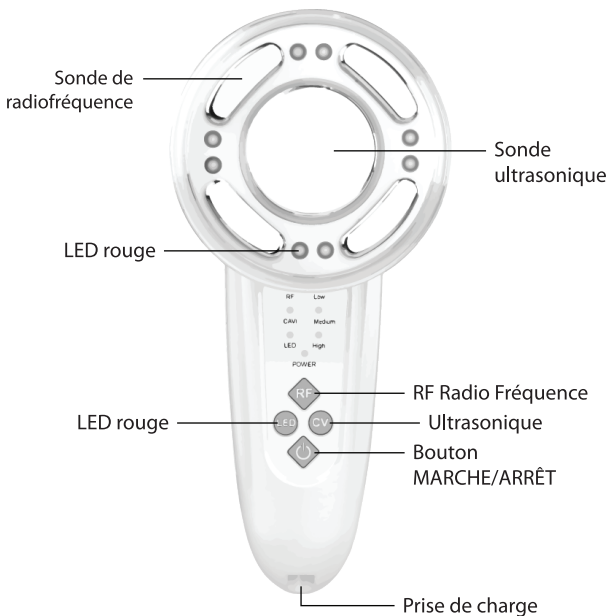

Avantages de l'appareil d'amincissement par ultrasons LED RF

Radiofréquence Trois modes différents permettent aux utilisateurs d'effectuer des traitements sur différents types et zones de peau, et de ne pas les abîmer.

La sonde de traitement extra large peut être employée pour effectuer des traitements sur de nombreuses zones, comme les bras, les cuisses ou le corps.

Combien de fois

Dix à quinze minutes pour chaque traitement.

Un à deux traitements par semaine sont recommandés.

Utilisation de l'appareil

Avant d'effectuer un traitement, vous devez procéder comme suit:

- Vérifiez s'il existe des contre-indications absolues ou relatives.
- Vérifiez que l'appareil marche correctement et que le cordon électrique n'est pas endommagé.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de matériaux inflammables à proximité de l'espace de travail.

Suivez les étapes suivantes pour réaliser un traitement:

- 1 Avant de commencer à vous en servir, chargez l'appareil pendant au moins 2 heures. (Remarque: le voyant d'alimentation clignote: Chargement LED d'alimentation fixe: Pleinement chargé

Pour le chargement:

Il suffit de connecter le câble USB à une source d'alimentation USB 5V commune. Connecter le câble à la prise de charge de l'appareil de massage.



NOTICE

Le masseur NE PEUT PAS être utilisé pendant la charge.



Utilisation de l'appareil

- 2** Désinfectez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et nettoyez minutieusement les électrodes et le couvercle de la LED



- 3** Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.



- 4** Appuyez sur le bouton LED pour activer la fonction LED rouge (mode continu).

Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer en mode pulsé. Il fournit de courtes impulsions spécifiques d'énergie lumineuse, qui améliorent les traitements



Utilisation de l'appareil

- 5** Appuyez sur le bouton CV pour activer la fonction d'amincissement par ultrasons.




- 6** Appuyez sur le bouton RF pour activer la fonction de radiofréquence.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton RF pour choisir la puissance RF souhaitée

Remarque: L'appareil est efficace à tous les niveaux d'intensité, y compris le réglage le plus faible. Il n'est pas indispensable d'utiliser le niveau d'intensité le plus élevé pour obtenir des résultats optimaux.



- 7** Si vous le souhaitez, utilisez de l'essence ou de la crème amincissante ou vos propres produits sur la zone à travailler pour obtenir les meilleurs résultats.




Utilisation de l'appareil


CORPS:

La durée approximative du traitement est de 5 à 10 minutes pour chaque zone (cuisses/jambes, fesses, dos, bras et abdominaux). Si vous le désirez, utilisez une essence amincissante sur les zones que vous allez traiter pour obtenir les meilleurs résultats.

ABS/ ESTOMAC: Il est recommandé que le traitement complet des abdominaux et du ventre dure 10 minutes. Effectuez de petits cercles lents sur la partie inférieure de l'abdomen. Soulevez et répétez pour le haut de l'abdomen.




Remontez lentement du haut des fesses vers le bas du dos. Soulevez et répétez sur une autre zone avec le même mouvement.



BRAS: Il est recommandé que le traitement complet du bras dure 5 minutes.

Faites de petits cercles lents, en remontant de l'arrière du coude vers l'intérieur de l'épaule. Soulevez et faites l'épaule extérieure.


Répétez l'opération pour l'avant des bras.



Utilisation de l'appareil


LES FESSES: Il est recommandé que le traitement complet des fesses dure 5 minutes.

Faites de petits cercles lents, en remontant de la partie supérieure de la cuisse arrière vers le haut des fesses. Soulevez et répétez l'opération sur une autre zone des fesses.



Faites des mouvements lents de haut en bas en faisant de petits zigzags sur les fesses.

Répétez pour l'autre joue.



JAMBES: Il est conseillé d'effectuer le traitement complet des jambes en 10 minutes.

Faites de petits cercles lents, en remontant de l'arrière du genou vers le haut de la cuisse extérieure. Soulevez et faites l'intérieur de la cuisse.



Entretien

- Après chaque utilisation, nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux. Séchez immédiatement toute trace d'humidité, de produits chimiques ou d'eau sur l'appareil
- Conservez l'appareil dans un endroit sec.
- Tenir hors de portée des enfants



Garantie

Le produit est assorti d'une garantie complète d'un an contre les défauts de fabrication. Elle ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un accident, un abus, une négligence ou d'autres causes externes. La garantie est annulée si une tension instable ou une alimentation électrique inappropriée a été utilisée.

Spécifications

Modèle No	PE142
Entrée	DC 5V 1A
Puissance de sortie	Max 11W
Fréquence d'ultrasons	330KHz
Fréquence radio	500KHz
Capacité de la batterie	1400mAh
Minuterie d'arrêt automatique	10min



E-mail: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com

Introducción

Gracias por comprar el dispositivo de adelgazamiento ultrasónico LED RF de Project E Beauty. Este dispositivo utiliza 3 funciones diferentes para tratar una variedad de condiciones de la piel y del cuerpo.

Lo que separa a este dispositivo de otros dispositivos de belleza es la sonda de ultrasonido extra grande. Combinado con la radiofrecuencia y los LEDs rojos, lleva el cuidado de la piel y la remodelación del cuerpo al siguiente nivel y conseguirá resultados más efectivos y rápidos de lo que se puede imaginar.

Características:

- Radiofrecuencia enfocada en 4 puntos
- Tecnología ultrasónica de 330K Hz
- Recargable por USB
- Fácil de manejar
- Sin ruido

Adelgazamiento por ultrasonidos

La tecnología de adelgazamiento por ultrasonidos es un proceso en el que se transmiten ondas de ultrasonidos a las zonas del cuerpo afectadas por la celulitis. La frecuencia de los ultrasonidos se ajusta para interrumpir las células de grasa que están causando la aparición de la celulitis. La continuación de la terapia de cavitación hace que la grasa sea absorbida por el sistema linfático y eliminada a través del hígado. La tecnología es muy eficaz y un verdadero avance tecnológico para deshacerse de la celulitis.



Introducción

RF (radiofrecuencia)

Para desintoxicar y favorecer la circulación sanguínea. Con la RF, la energía eléctrica seguirá la distancia más corta entre dos electrodos. Cuando la corriente eléctrica atraviesa un tejido vivo, el elevado flujo de energía produce calor, ya que el tejido vivo se resiste a la electricidad. La energía de RF puede calentar los tejidos de las capas dérmica y subcutánea de la piel. Además de aumentar la producción de colágeno y elastina, la radiofrecuencia también puede utilizarse para contraer las fibras de colágeno, lo que da lugar a un estiramiento de la piel. También se utiliza para mejorar el drenaje linfático, acelerar el metabolismo de las grasas y reducir la celulitis.

LED ROJO

El LED rojo penetra en la piel aproximadamente 8-10mm, lo que estimulará las células de fibra y la producción de colágeno, reduciendo las arrugas y haciendo la piel más elástica y suave.

Información de seguridad

El uso del dispositivo en las siguientes condiciones puede causar posibles perjuicios a la piel. No realice el tratamiento en las zonas afectadas del cuerpo de la persona.

Contraindicaciones relativas

- Cortaduras o abrasions
- Afecciones vasculares
- Pielles hipersensibles
- Vello corporal excesivo
- Obstrucción de los senos paranasales
- Enfermedades epidérmicas
- Infecciones
- Quemaduras solares
- Dolores de cabeza o migrañas



Información de seguridad

Debe leer y comprender todas las advertencias de seguridad y las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento antes de utilizar el dispositivo de adelgazamiento ultrasónico Project E Beauty LED RF.

ADVERTENCIA!: Un peligro que puede causar lesiones graves.

AVISO: Un peligro que puede causar daños al producto.

ADVERTENCIA

- La realización de un tratamiento en una persona con contraindicaciones absolutas puede causar lesiones graves o la muerte. No realice un tratamiento en una persona en la que existan contraindicaciones absolutas.
- No utilice nunca el aparato cerca del agua. Séquese siempre las manos antes de realizar un tratamiento.
- El uso del aparato cerca de joyas y metales puede provocar una descarga eléctrica inesperada. Quítese siempre todas las joyas y metales antes de un tratamiento.

No realice un tratamiento si la persona tiene alguna de estas condiciones.

Contraindicaciones absolutas

- | | |
|--|----------------------------|
| • Enfermedad infecciosa aguda o fiebre | • Epilepsia |
| • Náuseas | • Embarazo |
| • Disfunción o trastornos del sistema nervioso | • Flebitis o trombosis |
| | • Enfermedades del corazón |

NOTA: Si usted está bajo el cuidado de un médico por cualquier condición de la piel o si cree que puede tener una condición de la piel, por favor consulte a su médico antes de usar.

Qué se incluye




Dispositivo de adelgazamiento por ultrasonidos LED de Project E Beauty



Cable USB

Manual del propietario (no se muestra)

Ubicación de los controles

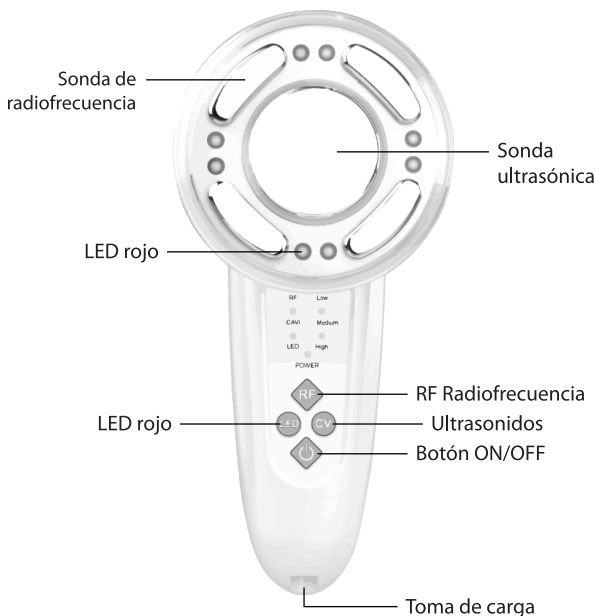

Beneficios del aparato de adelgazamiento por ultrasonidos LED RF

Radiofrecuencia Tres modos diferentes permiten a los usuarios realizar tratamientos en diferentes tipos de piel y zonas, y evitar que se dañen.

La sonda de tratamiento extragrande puede utilizarse para realizar tratamientos en numerosas zonas, como los brazos, la piel tensa o el cuerpo.

Con qué frecuencia

De diez a quince minutos por tratamiento.

Se recomienda uno o dos tratamientos a la semana.

Uso del dispositivo

Antes de realizar un tratamiento debe hacer lo siguiente:

- Compruebe si existen contraindicaciones absolutas o relativas.
- Compruebe que el aparato funciona correctamente y que el cable eléctrico no está dañado.
- Asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca del espacio de trabajo.

Siga estos pasos cuando realice un tratamiento:

- 1 Antes de usar el dispositivo por primera vez, cárguelo al menos 2 horas. (Nota: LED de alimentación parpadeante: Cargando LED de alimentación fijo: Completamente cargado)

Para la carga:

Simplemente conecta el cable USB a una fuente de alimentación USB común de 5V Conecta el cable a la toma de carga del masajeador.



AVISO

El masajeador NO puede utilizarse durante la carga



Uso del dispositivo

- 2** Desinfectar el aparato con un paño suave y limpiar cuidadosamente los electrodos y la cubierta del LED



- 3** Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encender la unidad.



- 4** Pulse el botón LED para activar la función del LED rojo (modo continuo).

Pulse de nuevo para cambiar al modo Pulso. Proporciona un pulso corto y específico de energía luminosa, que mejora los tratamientos.



Uso del dispositivo

- 5** Pulse el botón CV para activar la función de adelgazamiento por ultrasonidos.




- 6** Pulse el botón RF para activar la función de radiofrecuencia.

Pulse repetidamente el botón RF para seleccionar la potencia de radiofrecuencia deseada.

Nota: El aparato es eficaz en todos los niveles de intensidad, incluido el ajuste más bajo. No es necesario utilizar el nivel de potencia más alto para conseguir los máximos resultados.



- 7** Si lo desea, utilice Esencia Adelgazante, Crema o sus propios productos en la zona que va a trabajar para conseguir los mejores resultados.




Uso del dispositivo


CUERPO:

El tiempo de tratamiento aproximado es de 5-10 minutos para cada zona (muslos/piernas, glúteos, espalda, brazos y abdominales). Si lo desea, utilice una Esencia Adelgazante en las zonas que vaya a trabajar para conseguir los mejores resultados.

ABS/ESTÓMAGO: Se recomienda que el tratamiento completo de abdominales/estómago dure 10 minutos. Mueva lentamente en pequeños círculos, a través de la parte inferior del abdomen. Levantar y repetir para la parte superior del abdomen.




Suba lentamente desde la parte superior de las nalgas hacia la parte inferior de la espalda. Levante y repita en otra zona con el mismo movimiento.



BRAZOS: Se recomienda que el tratamiento completo de los brazos dure 5 minutos.

Muévete lentamente en pequeños círculos, hacia arriba desde la parte posterior del codo hasta el hombro interior. Levantar y hacer el hombro exterior.




Repita la operación con la parte delantera de los brazos.

Uso del dispositivo


NALGAS: Se recomienda que el tratamiento completo de las nalgas dure 5 minutos.

Despacio, en pequeños círculos, hacia arriba, desde la parte superior del muslo trasero hasta la parte superior de las nalgas. Levante y repita en otra zona de las nalgas.



Mueva lentamente hacia arriba y hacia abajo en un pequeño movimiento de zig-zag en las nalgas.

Repita con la otra mejilla.



PIERNAS: Se recomienda que el tratamiento completo de las piernas dure 10 minutos.

Muévete lentamente en pequeños círculos, hacia arriba, desde la parte posterior de la rodilla hasta la parte superior de la parte exterior del muslo. Levante y haga la parte interna del muslo.



Mantenimiento

- Después de cada uso, limpie la superficie con un paño suave. Seque inmediatamente cualquier humedad, producto químico o agua en el dispositivo
- Guarde el dispositivo en un lugar seco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños



Garantía

El producto tiene una garantía completa de un año contra defectos de fabricación. No incluye los daños causados por un mal uso, accidente, abuso, negligencia u otras causas externas. La garantía queda anulada si se ha utilizado un voltaje inestable o una fuente de alimentación inadecuada.

Especificaciones

Modelo.....	PE142
Entrada.....	DC 5V 1A
Potencia de salida.....	Max 11W
Frecuencia de ultrasonido.....	330KHz
Frecuencia de radio.....	500KHz
Capacidad de la batería.....	1400mAh
Temporizador de apagado automático.....	10min



E-mail: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com



Introduzione

Grazie per avere acquistato il Dispositivo Dimagrante Ultrasonico a RF e LED di Project E Beauty. Questo dispositivo usa 3 funzioni diverse per trattare una varietà di condizioni di pelle e corpo.

Ciò che distingue questo dispositivo dagli altri è la sonda a ultrasuoni extra large. Combinata con le Radiofrequenze e i LED Rossi, questo dispositivo porta la cura della pelle e il rimodellamento del corpo a un altro livello e ti permette di ottenere dei risultati in maniera più efficace e più veloce di quanto pensassi fosse possibile.

Caratteristiche:

- RF concentrate su 4 punti
- Tecnologia Ultrasonica a 330K Hz
- Ricarica USB
- Facile da Usare
- Silenzioso

Dimagrimento Ultrasonico

La tecnologia ultrasonica (a ultrasuoni) è un processo tramite cui si trasmettono delle onde ultrasoniche nelle aree del corpo affette da cellulite. La frequenza degli ultrasuoni ha lo scopo di distruggere le cellule di grasso che causano la cellulite. L'utilizzo continuativo di questa terapia fa scivolare il grasso nel sistema linfatico, che se ne libera attraverso il fegato. La tecnologia è molto efficace e una vera svolta per liberarsi della cellulite.



Introduzione

RF (Radiofrequenze)

Per la disintossicazione e per favorire la circolazione del sangue. Nelle RF l'energia elettrica segue la distanza più breve fra due elettrodi. Quando la corrente elettrica attraversa un tessuto vivo, l'alto flusso di energia produce calore, mentre il tessuto oppone resistenza all'elettricità. Il tessuto degli strati cutanei e sottocutanei della pelle può essere riscaldato tramite l'energia delle RF. Oltre ad aumentare la produzione di collagene ed elastina, le RF possono essere usate anche per fare contrarre le fibre di collagene, rassodando la pelle. Vengono usate anche per migliorare il linfodrenaggio, accelerare il metabolismo del grasso e ridurre la cellulite.

LED ROSSO

Il LED rosso penetra nella pelle di circa 8-10mm, il che stimola le cellule fibrose e la produzione di collagene, riducendo le rughe e rendendo la pelle più elastica e liscia.

Informazioni di Sicurezza

L'utilizzo del dispositivo in presenza delle seguenti condizioni potrebbe causare danni potenziali alla pelle. Non eseguire un trattamento ad alta frequenza sulle aree colpite da queste condizioni

Controindicazioni Relative

- Tagli o abrasioni
- Condizioni vascolari
- Pelle ipersensibile
- Excessive body hair
- Sinus blockages
- Disturbi o malattie della pelle
- Infezioni
- Scottature
- Mal di testa o emicranie



Informazioni di Sicurezza

Devi leggere e comprendere tutti gli avvertimenti di sicurezza, le istruzioni di utilizzo e di manutenzione prima di usare il Dispositivo Dimagrante Ultrasonico a RF e LED di Project E Beauty.

ATTENZIONE!: Un pericolo che potrebbe causare lesioni gravi.

NOTA BENE: Un pericolo che potrebbe causare danni al prodotto.

ATTENZIONE

- Eseguire un trattamento su una persona con controindicazioni assolute potrebbe causare lesioni gravi o morte. Non eseguire un trattamento su una persona nel caso di controindicazioni assolute.
- Non usare mai il dispositivo nelle vicinanze dell'acqua. Asciugare sempre le mani prima di eseguire un trattamento.
- L'uso del dispositivo in presenza di gioielli e metallo potrebbe causare delle folgorazioni inaspettate. Rimuovere sempre tutti i gioielli e i metalli prima del trattamento.

Non eseguire un trattamento se la persona soffre di una qualsiasi di queste condizioni.

Contrindicazioni Assolute

- | | |
|---|----------------------|
| • Malattie infettive acute o febbre | • Epilessia |
| • Nausea | • Gravidanza |
| • Disfunzioni o disordini del sistema nervoso | • Flebite o trombosi |
| | • Malattie cardiache |

NOTA: Se sei in cura da un medico per qualsiasi condizione della pelle o se pensi di potere soffrire di una malattia della pelle, consulta il tuo medico prima dell'uso.

Contenuto della Confezione




Dispositivo
Dimagrante a RF e LED
di Project E Beauty



Cavo USB

Manuale Utente (Non Rappresentato)

Posizione dei Comandi

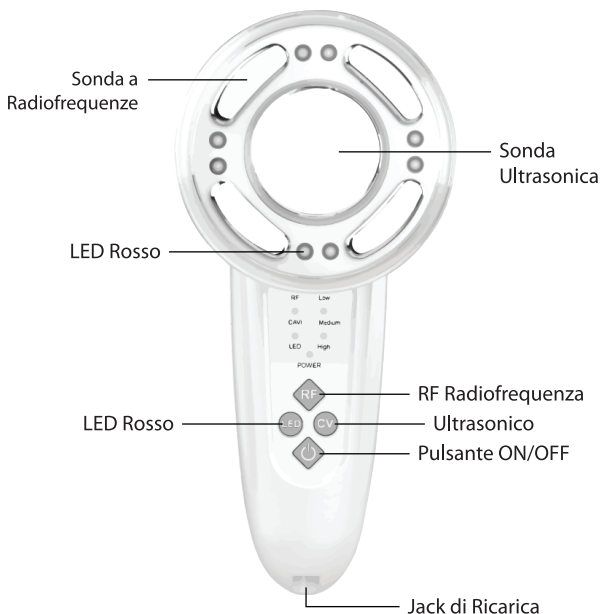

Vantaggi del Dispositivo Dimagrante a RF e LED

Le radiofrequenze in tre diverse modalità consentono agli utenti di eseguire dei trattamenti su tipi di pelle e zone diverse, evitando di subire danni.

La sonda extra large per il trattamento può essere usata per eseguire trattamenti in numerose zone, come braccia, cosce o corpo.

Vantaggi del Dispositivo Dimagrante a RF e LED

Quanto Usarlo

Dai dieci ai quindici minuti per trattamento.

Si consigliano uno o due trattamenti alla settimana.

Utilizzo del Dispositivo

Prima di eseguire un trattamento, dovresti:

- Controllare se sono presenti delle controindicazioni assolute o relative.
- Controllare che il dispositivo funzioni correttamente e che il cavo elettrico non sia danneggiato.
- Assicurarti che non ci siano dei materiali infiammabili vicino all'area di lavoro.

Segui questi passaggi per eseguire un trattamento:

- 1 Prima del primo utilizzo del dispositivo, caricalo per almeno 3 ore. (Nota: LED di accensione lampeggiante: in carica; LED di accensione fisso: carica completata)

Per la ricarica, connetti il cavo USB a una presa USB da 5V. Collega il cavo al jack di ricarica sul massaggiatore.



NOTA BENE

Il massaggiatore NON può essere usato durante la ricarica.



Utilizzo del Dispositivo

- 2** Disinfetta il dispositivo usando un panno morbido e pulisci con cura gli elettrodi e la copertura del LED.



- 3** Tieni premuto il pulsante On/Off per 2 secondi per accendere l'unità.



- 4** Premi il pulsante LED per attivare la funzione del LED Rosso (modalità continua). Premilo di nuovo per passare alla modalità pulsata, che fornisce delle pulsazioni brevi di energia luminosa che migliorano l'efficacia del trattamento.



Utilizzo del Dispositivo

- 5** Premi il pulsante CV per attivare la funzione dimagrante ultrasonica.




- 6** Premi il pulsante RF per attivare la funzione a Radiofrequenze. Premi ripetutamente il pulsante RF per selezionare la potenza delle RF desiderata.



Nota: Il dispositivo è efficace a tutti i livelli di intensità, incluso quello più basso. Non è necessario usare il livello di potenza più alto per ottenere i risultati migliori.

- 7** Se lo desideri, usa l'Essenza o la Crema Dimagrante o i tuoi prodotti sull'area su cui vuoi lavorare per ottenere i risultati migliori.




Utilizzo del Dispositivo


CORPO:

Il tempo approssimativo per un trattamento è di 5-10 minuti per ciascuna area (Cosce/Gambe, Glutei, Schiena, Braccia e Addome). Se lo desideri, usa un'Essenza Dimagrante sulle aree su cui vuoi lavorare per ottenere i risultati migliori.

ADDOME/SCHIENA: Si consiglia di eseguire un trattamento da 10 minuti. Muovi il dispositivo lentamente con movimenti circolari sul basso ventre. Sollevalo e ripeti il movimento sulla parte superiore dell'addome.




Muovi lentamente il dispositivo verso l'alto dalla parte superiore dei glutei verso la zona lombare. Sollevalo e ripeti su un'altra area con lo stesso movimento.



BRACCIA: Si consiglia di eseguire un trattamento da 5 minuti.


Muovi lentamente il dispositivo con movimenti circolari verso l'alto, dal retro del gomito alla parte interna della spalla. Sollevalo e ripeti sulla parte esterna della spalla. Ripeti il processo sulla parte anteriore delle braccia.



Utilizzo del Dispositivo


GLUTEI: Si consiglia di eseguire un trattamento di 5 minuti.

Muovi lentamente il dispositivo con movimenti circolari verso l'alto, dalla parte posteriore della coscia fino alla parte superiore dei glutei. Sollevalo e ripeti il processo su un'altra area dei glutei.



Muovi lentamente il dispositivo in alto e in basso con un movimento a zig zag sui glutei.

Ripeti sull'altro lato.



GAMBE: Si consiglia di eseguire un trattamento di 10 minuti.

Muovi lentamente il dispositivo con movimenti circolari verso l'alto, da sopra la parte posteriore del ginocchio fino alla fine dell'esterno coscia. Sollevalo e ripeti il processo sull'interno coscia.



Manutenzione

- Pulire la superficie con un panno morbido dopo ogni utilizzo. Asciugare subito per rimuovere umidità, sostanze chimiche o acqua dal dispositivo.
- Conservare il dispositivo in un luogo asciutto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini



Garanzia

Il prodotto è dotato di una garanzia completa di un anno che copre i difetti di fabbrica. Non include i danni causati da un utilizzo scorretto, incidenti, abusi, negligenza o altre cause esterne. È nulla se vengono usate una corrente instabile o una fonte di energia inappropriata.

Specifiche

Modello N	PE142
Input.....	DC 5V 1A
Potenza Output	Max 11W
Frequenza Ultrasuoni.....	330KHz
Frequenza Radio.....	500KHz
Capacità Batteria.....	1400mAh
Timer Spegnimento Automatico.....	10min



E-mail: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com

Einführung

Vielen Dank, dass **Sie** sich für das Project E Beauty LED RF Ultrasonic Slimming Device entschieden haben. Dieses Gerät nutzt 3 verschiedene Funktionen, um eine Vielzahl von Haut- und Körperzuständen zu behandeln.

Was dieses Gerät von anderen Beauty-Geräten unterscheidet, ist die extra große Ultraschallsonde. In Kombination mit Radiofrequenz und roten LEDs hebt dies die Hautpflege und Körperformung auf die nächste Stufe und Sie werden Ergebnisse effektiver und schneller erzielen als Sie es sich vorstellen können.

Merkmale:

- 4-Punkt-Fokus RF
- 330K Hz-Ultraschalltechnik
- USB Wiederaufladbar
- Einfach zu bedienen
- Geräuschfrei

Abnehmen mit Ultraschall

Die Ultraschall(Ultrasound)-Schlankkeitsbehandlung ist ein Verfahren, bei dem Sie Ultraschallwellen in die von Cellulite betroffenen Bereiche Ihres Körpers senden. Die Frequenz des Ultraschalls ist so eingestellt, dass die Fettzellen, die das Auftreten der Cellulite verursachen, gestört werden. Die Fortsetzung der Kavitationstherapie bewirkt, dass das Fett im Lymphsystem aufgewirbelt und über die Leber entsorgt wird. Die Technologie ist sehr effektiv und ein echter technologischer Durchbruch, um Cellulite loszuwerden.



Einführung

RF (Radiofrequenz)

Zur Entgiftung und Förderung der Blutzirkulation. Bei RF folgt die elektrische Energie dem kürzesten Abstand zwischen zwei Elektroden. Wenn der elektrische Strom durch lebendes Gewebe fließt, erzeugt der hohe Energiefluss Wärme, da das lebende Gewebe der Elektrizität widerstehen wird. Gewebe sowohl in den dermalen als auch in den subkutanen Schichten der Haut kann durch RF-Energie erwärmt werden. Neben der Steigerung der Kollagen- und Elastinproduktion kann RF auch zur Kontraktion der Kollagenfasern eingesetzt werden, was zu einer Hautstraffung führt. Sie wird auch zur Verbesserung der Lymphdrainage, zur Beschleunigung des Fettstoffwechsels und zur Reduzierung von Cellulite eingesetzt.

ROTE LED

Die rote LED dringt ca. 8-10 mm in die Haut ein, was die Faserzellen und die Produktion von Kollagen stimuliert, wodurch Falten reduziert und die Haut elastischer und glatter wird.

Sicherheitshinweise

Die Verwendung des Geräts bei Vorliegen der folgenden Bedingungen kann zu möglichen Schäden an der Haut führen. Führen Sie keine Behandlung an den betroffenen Körperstellen der Person durch.

Relative Kontraindikationen

- Schnitte oder Abschürfungen
- Vaskuläre Bedingungen
- Überempfindliche Haut
- Übermäßige Körperbehaarung
- Verstopfung der Nasennebenhöhlen
- Hautstörungen oder-krankheiten
- Infektionen
- Sonnenbrand
- Kopfschmerzen oder Migräne



Sicherheitshinweise

Sie müssen **alle** Sicherheitswarnungen, Betriebs- und Wartungsanweisungen lesen und verstehen, bevor Sie das Project E Beauty LED RF-Ultraschall-Schlankheitsgerät verwenden.

WARNUNG! Eine Gefahr, die zu schweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS: Eine Gefahr, die zu Schäden am Produkt führen kann.

WARNUNG

- Die Durchführung einer Behandlung an einer Person mit absoluten Kontraindikationen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Führen Sie keine Behandlung an einer Person durch, für die absolute Kontraindikationen bestehen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser. Trocknen Sie immer Ihre Hände, bevor Sie eine Behandlung durchführen.
- Die Verwendung des Geräts in der Nähe von Schmuck und Metall kann zu einem unerwarteten elektrischen Schlag führen. Legen Sie vor einer Behandlung immer alle Schmuckstücke und Metalle ab.

Führen Sie keine Behandlung durch, wenn die Person einen dieser Zustände hat.

Absolute Kontraindikationen

- | | |
|---|----------------------------|
| • Akute Infektionskrankheit oder Fieber | • Epilepsie |
| • Übelkeit | • Schwangere |
| • Funktionsstörungen oder Störungen des Nervensystems | • Phlebitis oder Thrombose |
| | • Herzkrankheit |

HINWEIS: Wenn Sie wegen einer Hauterkrankung in ärztlicher Behandlung sind oder wenn Sie glauben, eine Hauterkrankung zu haben, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung Ihren Arzt.

Was ist inbegriffen




Projekt E Schönheit LED
RF-Ultraschall-Schlankh
eitsgerät



USB-Kabel

Benutzerhandbuch (nicht abgebildet)

Lage der Bedienelemente

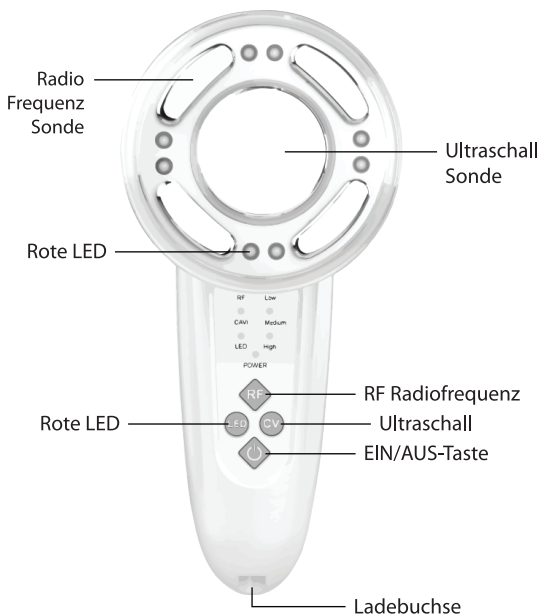

Vorteile LED RF-Ultraschall-Schlankheitsgerät

Radiofrequenz Drei verschiedene Modi ermöglichen es den Anwendern, Behandlungen an verschiedenen Hauttypen und -bereichen durchzuführen und diese vor Schäden zu bewahren.

Die extra große Behandlungssonde kann zur Behandlung zahlreicher Bereiche, wie z. B. Arme, Taille oder Körper, verwendet werden.

Vorteile LED RF-Ultraschall-Schlankheitsgerät

Wie oft

Zehn bis fünfzehn Minuten für jede Behandlung.
Es werden ein bis zwei Behandlungen pro Woche empfohlen.

Verwendung des Geräts

Bevor Sie eine Behandlung durchführen, sollten Sie Folgendes tun:

- Prüfen Sie, ob absolute oder relative Kontraindikationen bestehen.
- Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert und das Stromkabel nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe des Arbeitsbereichs befinden.

Befolgen Sie diese Schritte bei der Durchführung einer Behandlung:

- 1** Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung mindestens 2 Stunden auf. (Hinweis: Blinkende Power-LED: Aufladen Dauerhafte Power-LED: Vollständig aufgeladen)

Zum Laden:

Schließen Sie das USB-Kabel einfach an eine gängige 5-V-USB-Stromquelle an. Verbinden Sie das Kabel mit der Ladebuchse am Massagegerät.



NOTA BENE

Das Massagegerät kann NICHT während des Ladevorgangs verwendet werden



Verwendung des Geräts

- 2** Desinfizieren Sie das Gerät mit einem weichen Tuch und reinigen Sie vorsichtig die Elektroden und die LED-Abdeckung



- 3** Halten Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.



- 4** Drücken Sie die LED-Taste, um die Funktion der roten LED einzuschalten (Dauerbetrieb).

Drücken Sie erneut, um in den Pulse-Modus zu wechseln. Er liefert kurze spezifische Lichtimpulse, die die Behandlungen verstärken.



Verwendung des Geräts

- 5** Drücken Sie die CV-Taste, um die Ultraschall-Schlankheitsfunktion einzuschalten.




- 6** Drücken Sie die RF-Taste, um die Radiofrequenzfunktion einzuschalten.

Drücken Sie wiederholt die RF-Taste, um die gewünschte RF-Leistung auszuwählen.



Hinweis: Das Gerät ist bei allen Intensitätsstufen wirksam, auch bei der niedrigsten Einstellung. Es ist nicht notwendig, die höchste Leistungsstufe zu verwenden, um maximale Ergebnisse zu erzielen.

- 7** Falls gewünscht, verwenden Sie Schlankheitssessenz, Creme oder Ihre eigenen Produkte auf dem zu bearbeitenden Bereich, um die besten Ergebnisse zu erzielen.




Verwendung des Geräts


KÖRPER:

Die ungefähre Behandlungszeit beträgt 5-10 Minuten für jeden Bereich (Oberschenkel/Beine, Gesäß, Rücken, Arme und Bauch). Falls gewünscht, verwenden Sie eine Schlankheitssensenz auf den Bereichen, an denen Sie arbeiten, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

ABS/STOMACH: Es wird empfohlen, dass die komplette Bauchbehandlung 10 Minuten dauert. Bewegen Sie sich langsam in kleinen Kreisen über den Unterbauch. Heben Sie an und wiederholen Sie den Vorgang für den Oberbauch.




Bewegen Sie sich langsam von der Oberseite des Gesäßes nach oben in Richtung des unteren Rückens. Heben Sie an und wiederholen Sie dies an einer anderen Stelle mit der gleichen Bewegung.



ARME: Es wird empfohlen, dass die komplette Armbehandlung 5 Minuten dauert.

Bewegen Sie sich langsam in kleinen Kreisen, von der Rückseite des Ellenbogens nach oben zur inneren Schulter. Heben Sie an und machen Sie die äußere Schulter.


Wiederholen Sie den Vorgang für die Vorderseite der Arme.



Verwendung des Geräts


BUTTOCKS: Es wird empfohlen, dass die komplette Gesäßbehandlung 5 Minuten dauert.

Bewegen Sie sich langsam in kleinen Kreisen vom oberen hinteren Oberschenkel nach oben zur Oberseite des Gesäßes. Heben Sie an und wiederholen Sie dies an einer anderen Stelle des Gesäßes.



Bewegen Sie sich langsam in einer kleinen Zick-Zack-Bewegung am Gesäß auf und ab.

Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Wange.



BÄDER: Es wird empfohlen, dass die komplette Beinbehandlung 10 Minuten dauert.

Bewegen Sie sich langsam in kleinen Kreisen aufwärts von oberhalb der Kniekehle bis zur Oberseite des äußeren Oberschenkels. Heben Sie an und machen Sie den inneren Oberschenkel.



Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch. Trocknen Sie Feuchtigkeit, Chemikalien oder Wasser auf dem Gerät sofort ab
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren



Garantie

Das Produkt wird mit einer einjährigen Vollgarantie gegen Herstellerfehler geliefert. Sie umfasst keine Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung oder andere äußere Ursachen entstanden sind. Die Garantie erlischt, wenn eine instabile Spannung oder eine ungeeignete Spannungsversorgung verwendet wurde.

Spezifikationen

Modell-Nr.....	PE142
Eingang.....	DC 5V 1A
Ausgangsleistung.....	Max 11W
Ultraschallfrequenz	330KHz
Radiofrequenz	500KHz
Batteriekapazität	1400mAh
Auto Shut Off Timer	10min



E-mail: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com

